



Manual de Operação

Instalação, Operação, Instruções de Manutenção



CF420/ F420 + RCF420

Transmissor de Fluxo por
Dispersão Térmica

Índice

Introdução	3
Modelos e Dimensões	4
Diagrama elétrico	5
Pré-Instalação	8
Instalação	9
Calibração	11
Manuseio	13
Especificações Técnicas	14
Código de Pedido	16
Solução de Pequenos Problemas	17
Termos e Condições	18

CF420/ F420 + RCF420

Transmissor de Fluxo por Dispersão Térmica



O modelo CF420 é um transmissor ideal para monitorar e controlar o fluxo de líquidos. Fornece um sinal analógico de 4...20mA e uma saída PNP. Esta tecnologia geralmente é ideal quando o usuário necessita da taxa de fluxo aproximada, mas não deseja investir na tecnologia mais cara dos medidores de vazão.

Para a saída PNP (500mA), o fluxo medido é comparado ao valor de ajuste (set point) selecionado pelo usuário, sinalizando e indicando quando este valor for alcançado.

Este transmissor usa o princípio da dispersão térmica a qual é alterada proporcionalmente à variação da velocidade do fluxo.

Para tubulações com diâmetro pequeno o modelo F420 é ideal pois, o sensor é separado da eletrônica, não possui cabeçote e pode ser controlada remotamente pelo Relé de controle de fluxo modelo RCF420. O modelo F420 + RCF420 é a solução para ambientes com pouco espaço e também quando é preciso um controle remoto com saídas digitais.

Um Bargraph de 8 Led's fornece ao usuário uma indicação visual de fluxo bem como o estado do Set-point e um LED central bi-cromático que indica quando o Set-point foi atingido.

O elemento sensor e as conexões dos modelos CF420/ F420 são confeccionados em aço-inox 316 e podem ser fornecidas em Hastelloy C.


Características

- Simples Instalação.
- Sem partes móveis e fácil manutenção.
- Tempo rápido de resposta.
- Pode ser revestida para meios agressivos.
- Pressão máxima de trabalho 1450 PSI (100 bar) ou 300 bar (encomenda).
- Disponível em rosca, sanitária e comprimento de inserção ajustável.


Modelos e Dimensões

CF420 Opções de montagem

Cabeçote N1




Cabeçote G1




Insertion Length


Padrão



Tri-Clamp

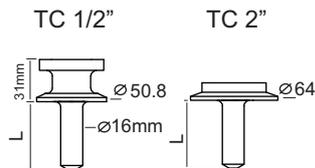


Pescoço para alta temperatura




Opções de montagem para F420 e RCF420



Pressa Cabo



Conector M12



RCF420

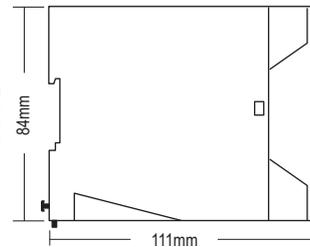



Conexões ao processo

Rosca	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/2"	

Tri-Clamp	
1"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	


Flange	
1"	ANSI 150# ANSI 300# FF
1 1/2"	FF
2"	RE
2 1/2"	RE

CF420 Cabeçote em Nylon (N1)

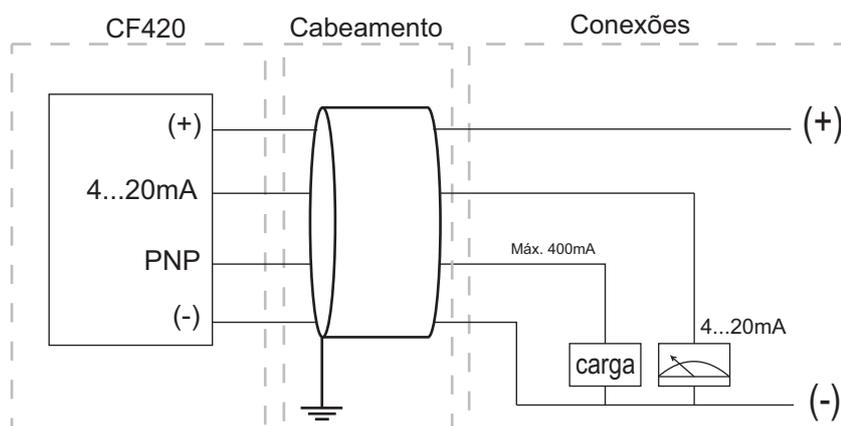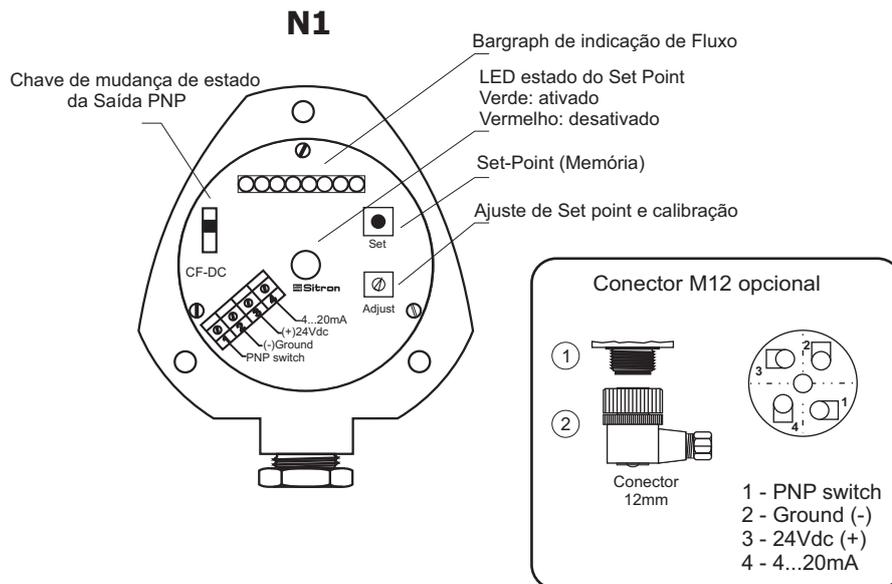


Conexões Elétricas


CF420 Cabeçote em Alumínio (G1)

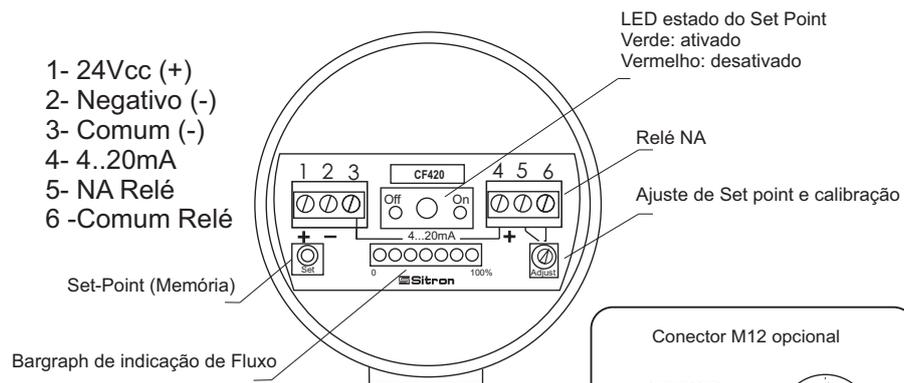


Conector M12 opcional



Padrão

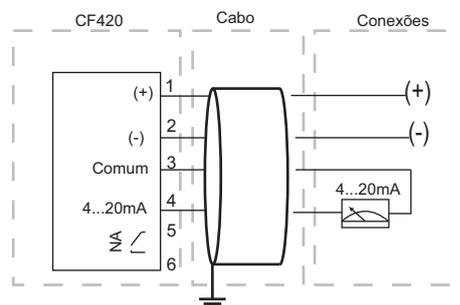


Conector M12

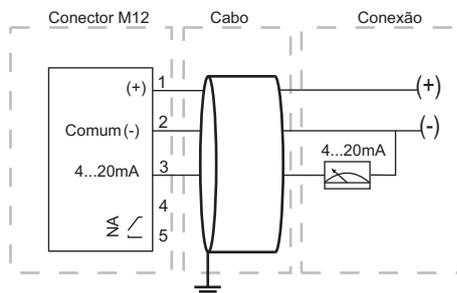


Conexões Elétricas


F420 e Controlador Remoto RCF420

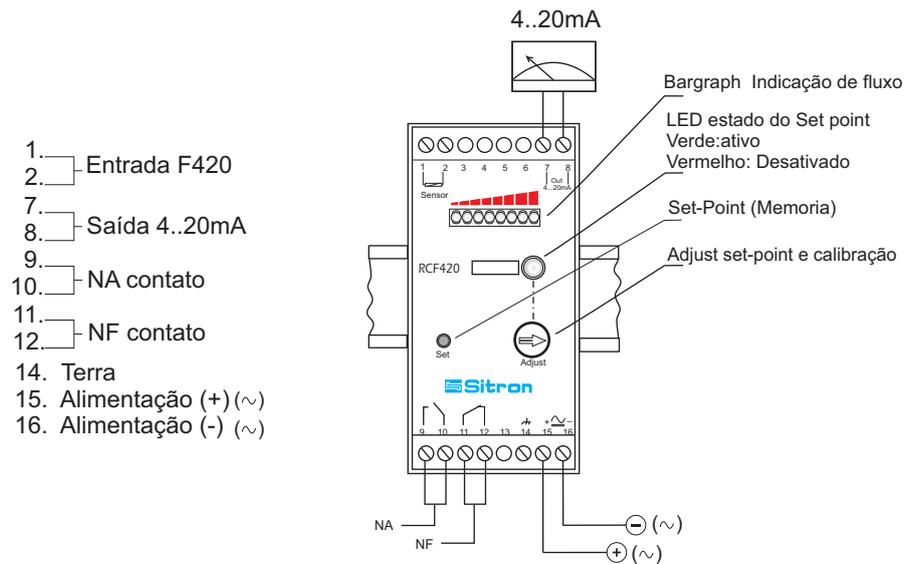

F420 - Prensa Cabo

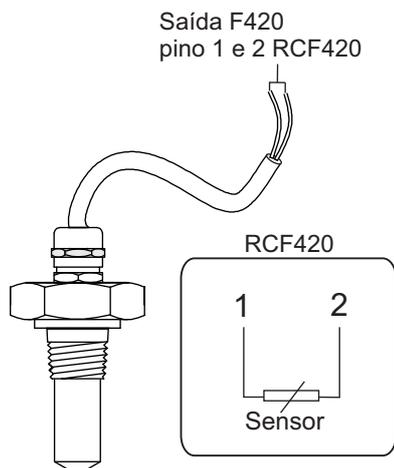

F420 - Conector M12

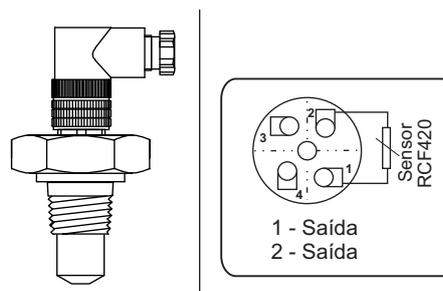

Pre-Instalação

Pré-Instalação

1) Antes de instalar a CF420 ou F420 certifique-se de que o local da instalação não seja perto de válvulas, conexões, cotovelos, curvas, conexões "T" ou similares, isto pode causar erro na leitura da sonda devido a turbulência dentro da tubulação.





É recomendado instalar com a distância de $\frac{1}{2}$ metro depois da entrada ou curva de fluxo e 5 vezes o diâmetro na saída ou curva do mesmo, isso evita erro de leitura devido a turbulência da tubulação (Fig. 1).

2) Em tubulação de saída ou que tenha descarga recomendamos que o transmissor seja instalado numa guarda hidráulica. Certifique-se que o ponto da instalação esteja sempre cheia, cobrindo totalmente a ponta do sensor e que não tenha risco de acúmulo de ar. (Fig. 2 correto, fig. 3 incorreto)

3) Em locais com a presença de bombas de recalque e válvulas de retenção é aconselhável a instalação do transmissor na tubulação de sucção da bomba por esta apresentar um baixo nível de turbulência (Fig. 4)

4) Antes da instalação conferir se as conexões dos cabos estão corretas e que a tensão da rede seja compatível com as especificações do equipamento

5) Verifique se a pressão e temperatura do processo corresponde aos parâmetros de funcionamento do equipamento.

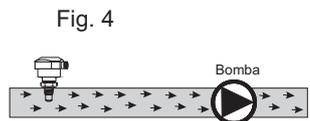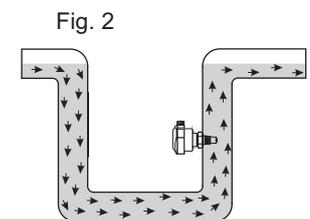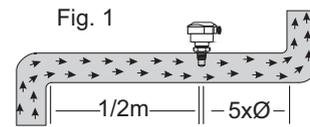

Instalação

Ao fazer as conexões entre o controlador e a sonda use cabos de confiança e certifique-se de que estejam bem aterrados.


Cabos com blindagem previne interferência e mau funcionamento na eletrônica prevenindo e protegendo contra falsas medições

Mantenha equipamentos de Rádio frequência longe da CF420 e RCF420. Se o contato for inevitável faça uma proteção metálica em torno do controlador e da CF420 e confirme se a proteção foi devidamente aterrada.

Não instale o controlador em ambiente agressivo e húmido. Respeite a classe de proteção, temperatura de trabalho e proteja contra chuva e calor excessivo.



Montagem do Controlador

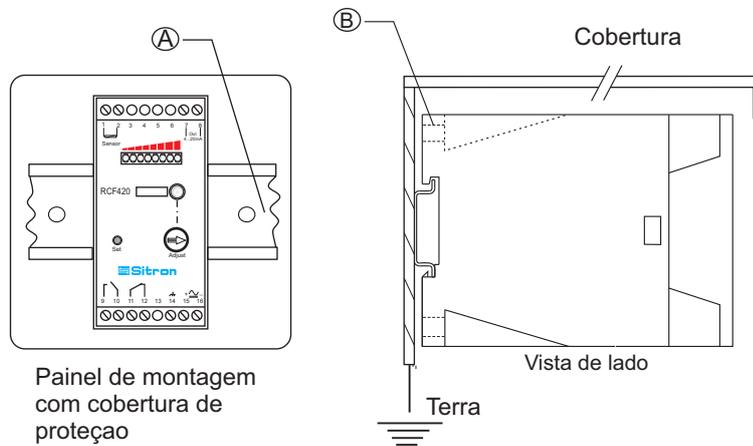

Painel de montagem com cobertura de proteção

A- Trilho DIN (35mm)

B- Parafusos

Instalação

Instalação







Os transmissores de fluxo modelos CF420 e F420 pode ser instalada em duto, tubulações ou tanques (p/ nível), por meio de niple ou conexão tipo "T" (Veja a fig. 1) ou inserida direto na tubulação (Veja a fig. 2). Adaptar a instalação conforme as seguintes recomendações.

O transmissor não é afetado pela sua posição, por isso pode ser instalado em qualquer ângulo ao redor do tubo. No entanto, é recomendado que, quando o tubo está na posição horizontal, a instalação seja na lateral, de forma que a ponta da sonda fique no meio do tubo (Veja a fig. 2).

Para instalação em tubulação vertical o fluxo deve ser sempre ascendente. Tenha certeza de que o cabo conectado esteja voltado para baixo em forma de "U" para evitar que umidade entre pelo conector ou cabeçote (Fig.7). (fig. 3).

Alguns cuidados devem ser tomados durante a instalação para que a sonda se estenda até o centro do tubo, mantendo distância das paredes internas, totalmente imersa no fluxo (Fig. 4 e 5 incorreta, Fig. 1 e 2 estão corretas).


Para permitir o uso do transmissor em tubulações com diâmetros pequenos, deve ser utilizado um adaptador que aumentará o diâmetro da tubulação num pequeno trecho, possibilitando a instalação da chave de fluxo, como ilustra a figura 6.



Manuseio

Passar veda-rosca (PTFE) antes de rosquear.
(Fig. 1).

Fig. 1




Não Girar, apertar ou soltar pelo cabeçote
(Fig. 2).

Fig. 2



Apertar utilizando uma chave correta através do
sextavado (Fig. 3).

Fig. 3




O instrumento não deverá sofrer qualquer tipo de
impacto ou queda sob o risco de danificar seus
componentes e o sensor instalado na ponta da
haste (Fig. 4 e 5).

É recomendada a inspeção visual periódica da
CF420 e F420, para prevenção de corrosão ou
acúmulo de resíduos. Se for detectado o acúmulo
de resíduos é recomendada a limpeza, para
garantir um perfeito funcionamento.


Quando utilizado o transmissor com
revestimento, deve-se manusear com precaução,
pois pontos com revestimento danificado podem
permitir o ataque químico do aço inox 316.

Fig. 4



Limpe a sonda com escova macia ou objeto
similar.

Fig. 5



Calibração

CF420 ou RCF420 **Ajuste dos 4..20mA**

1) - Instale a CF420 na tubulação, bem como as ligações elétricas.

2) - Verifique se as ligações elétricas estão corretas e se a tensão de alimentação é compatível com a mostrada na etiqueta da CF420.

Recomendamos fazer a calibração com um multímetro para melhor visualização da corrente de saída.





Fig.1



Ajustando 4mA:

3) Com a tubulação cheia de líquido (velocidade=0) gire o trimpot totalmente para a esquerda e em seguida pressione o botão de "SET" para gravar o valor que será calibrado em 4mA (Fig.1).

4) - O Led central piscará por alguns segundos. Espere até que ele pare de piscar.

Obs. Se algum erro ocorrer (o led central não piscar durante a calibração) pressione o botão SET outra vez até o mesmo piscar.

Use a seguinte fórmula para checar se a velocidade do processo está dentro do especificado.

Range:

V = velocidade (m/s)

Q= Taxa de fluxo (m³/s)

D= Diâmetro da tubulação (m)

$$V = \frac{1.27 \times Q}{D^2}$$

Ajustando 20mA

5) - Inicie o fluxo desejado com velocidade máxima. Gire o trimpot totalmente para a direita e em seguida pressione o botão "SET" novamente para gravar o valor que será calibrado em 20mA.

6) O led central piscará por alguns segundos. Espere até que ele pare de piscar (Fig.2).

Acertando o Set point;

7) - Depois de calibrar a CF420, ajuste o Set point no ponto desejado pelo trimpot. Use o bargraph de 8 Led's para achar o ponto correto que é ativado pelo led piscando (Fig.3).

Obs. Se algum erro ocorrer (o led central não piscar durante a calibração) pressione o botão "SET" outra vez até o mesmo piscar.

nota: Para calibrar o controlador RCF420 basta seguir os passos de 3 a 7.




Fig.2




Fig.3


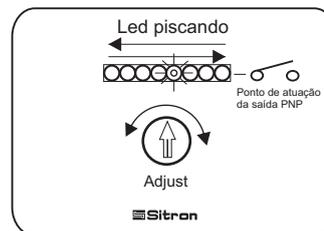


Diagrama de acionamento da Saída PNP

Posição da chave	Condição	Saída PNP	LED verde	LED vermelho
	 Fluxo	Atuada	ON	OFF
	 Sem fluxo	Atuada	OFF	ON

Especificação Técnica


CF420

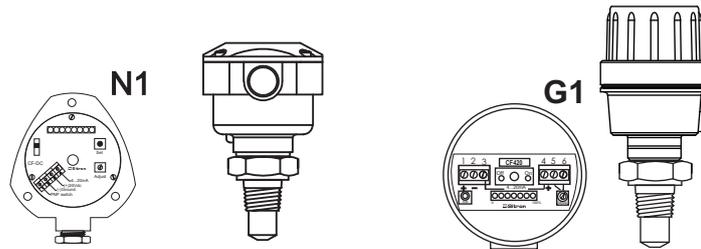

Aplicação	Monitorar e controlar o fluxo
Alimentação	DC - 24Vdc (+/- 10%)
Corrente de Consumo	Max. 1VA
Saída	N1: 4...20mA / Saída PNP (Max 400mA) G1: 4...20mA / Relé NA
Set Point (regulagem)	Água: 0,2 a 2 m/s Oléo: 0,4 a 4 m/s
Precisão	+/- 10%
Tempo de Resposta	3 a 10s
Repetibilidade	+/- 1% setpoint
Indicação de Fluxo	8 LED's bragraph Led vermelho central - fluxo abaixo do setpoint Led verde central - fluxo acima do setpoint
Cabeçote	N1 Nylon ou G1 alumínio
Conexões Elétricas	Prensa cabo 1/2"NPT ou conector M12
Conexões ao Processo	1/2" a 1 1/2" BSP ou NPT, Rosca, sanitária ou flange
Partes molhadas	Aço-inox 316
Temperatura de Operação	14 a 176° F (-10 a 80°C) ou c/ dissipador de calor 248°F (120°C)
Max Pressure	1450 PSI (100 Bar) ou 4500 PSI (300bar) sob pedido
Fixação	----
Classe de Proteção	Sensor: IP 65 Controlador: IP 40

Especificações Técnicas

F420 + RCF420

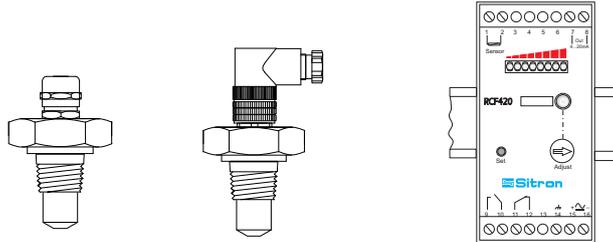

Aplicação	Monitorar e controlar o fluxo
Alimentação	DC - 24Vdc (+/- 10%) AC - 85-240Vac ou 125Vdc
Corrente de Consumo	Max. 1VA
Saída	4..20mA e Relé (NA + NF)
Set Point (regulagem)	Água: 0,2 a 2 m/s Oléo: 0,4 a 4 m/s
Precisão	+/- 10%
Tempo de Resposta	3 a 10s
Repetibilidade	+/- 1% setpoint
Indicação de Fluxo	8 LED's bargraph Led vermelho central - fluxo abaixo do setpoint Led verde central - fluxo acima do setpoint
Invólucro	Controlador: ABS
Conexões Elétricas	Prensa cabo c/ (2000mm) Conector M12
Conexões ao Processo	½" a 1 1/2" BSP ou NPT, Rosca, sanitária ou flange
Partes molhadas	Aço inox 316
Temperatura de Operação	14 a 176° F (-10 a 80°C)
Max Pressure	1450 PSI (100 Bar) ou 4500 PSI (300bar) sob pedido
Fixação	Controlador: Trilho DIN 35mm ou 2 parafusos
Classe de Proteção	Sensor: IP 65 Controlador: IP 40

Código de Pedido

MODEL								
CF420								
F420								
SIZE								
3	1/2"							
4	3/4"							
5	1"							
CONEXÕES AO PROCESSO								
6	1 1/2" B BSP							
7	2" D Flange ANSI 150# - Aço Carbono Pintado							
8	2 1/2" E Flange ANSI 150# - 316 SS							
9	3" F Flange ANSI 150# - PVC							
A	1 1/4" G Flange ANSI 300# - Aço Carbono Pintado							
B	Rosca H Flange ANSI 300# - 316 SS							
J	Métrica J Flange ANSI 300# - PVC							
K	4" K Flange ANSI 150# - 304 SS							
L	L Flange ANSI 300# - 304 SS							
M	M Rosca Métrica (ex. M30)							
N	N NPT							
R	R SMS Fêmea							
S	S SMS Macho							
T	T TRI-CLAMP							
Y	Y DIN Fêmea - 316SS							
X	X Outros - Especificar							
REVESTIMENTO								
S	S Nenhum							
COMPRIMENTO DE INSERÇÃO								
L35	L35 35mm							
L50	L50 50mm							
L75	L75 75mm							
L100	L100 100mm (>=100mm conexão a partir de 3/4")							
L	L Especificar							
CABEÇOTE								
SC	SC Sem Cabeçote							
N1	N1 NYLON Pequeno							
NE	NE NYLON Encapsulado							
GT	GT Alumínio com pintura							
GE	GE Alumínio com pintura encapsulado							
CONEXÃO ELÉTRICA								
0	0 Nenhum							
1	1 1/2" BSP (N1/G1)							
2	2 Prensa Cabo c/ 1/2" BSP (N1)							
3	3 Prensa Cabo W/ 1/2" BSP - 2m Cabo (N1/G1)							
4	4 3/4" BSP (G1)							
5	5 Prensa Cabo c/ 3/4" BSP (G1)							
7	7 Prensa Cabo 1/2" NPT							
8	8 Prensa Cabo 1/2" NPT - 2m Cabo (N1/G1)							
9	9 3/4" NPT c/ 2 metros de Cabo (G1)							
C	C Prensa Cabo 3/4" NPT (G1)							
J	J M15.8 Conector (9 Pinos) (G1)							
M	M M12 conector (Macho + Fêmea) F420							
Y	Y Prensa Cabo de Aço M16 c/ 2m PVC Cabo (F420)							
OPÇÕES								
MT	MT Temperatura Média - 50mm Prolongador 316SS (80-120°C)							
ST	ST Plaqueta de Identificação Tag							
CF420	4	N	S	L50	N1	7	MT	ST
MODELOS								
CF420RM DC	Controlador para Sensor remoto F420 c/ alimentação 24Vdc (+/- 10%)							
CF420RM AC	Controlador para Sensor remoto F420 c/ alimentação 85...240 Vac							

Solução de Pequenos Problemas

Falha	Causa	Solução
Sáida PNP ou Relé não muda de estado.	LED off, sem alimentação	Verifique a alimentação
	LED não muda de cor	Verifique a instalação (comprimento de inserção)
Sinal de saída (4..20mA)fixo	fora de calibração	Verificar a calibração
	Instalação incorreta (comprimento de inserção)	Verificar a instalação (comprimento de inserção)
CF420 liga e desliga repentinamente	Interferência por Rádio frequência	Use cabeamento blindado com o correto aterramento da malha
PNP ou Relé sempre ativo ou fechado	Sensor ou eletrônica com defeito	Entre em contato com a Sitron para realizar o suporte técnico

Assistência Técnica Sitron

Entre em contato para solução de:

- Dúvidas técnicas
- Garantia
- Assistência ou acompanhamento do conserto

Fale com nosso técnico

TEL. 3825-2111 R: 2306

Termos e Condições

Taxas para o cancelamento:

Pedido entregue mas não liberado para fabricação	10%
Pedido em fase de produção	75%
Pedido concluído e pronto para a expedição	100%

Garantia: a Sitron oferece garantia de seus produtos contra defeitos de fabricação, quando for instalado em aplicações aprovadas pela Sitron, por um período de 1 (um) ano a contar da data de expedição, exceto quando especificado por escrito pela Sitron.

A Sitron não se responsabiliza por danos causados em seus produtos ou outros equipamentos causados por instalação inadequada ou má aplicação por parte do comprador. A instalação e a inicialização do equipamento devem ser cumpridas de acordo com as orientações no manual de instalação, diagrama elétrico, etc., ou realizada diretamente com supervisão de um técnico da Sitron ou representante de vendas autorizado, para ser coberto pela garantia Sitron.

A Sitron não se responsabiliza por defeitos devido à desgaste, dano intencional, negligência, condições anormais de trabalho, alteração ou tentativa em fazer manutenção dos equipamentos sem aprovação da Sitron.

O comprador deve disponibilizar todos os recursos e pessoal para ajudar a Sitron a diagnosticar o defeito sem custo adicional. Na falta de cooperação por parte do comprador, a este respeito, não será cobrado o cumprimento da garantia acima.

Devolução de mercadoria: nenhum produto pode ser devolvido sem autorização da Sitron e sem um número ADM. A Sitron não se responsabiliza por mercadorias devolvidas sem autorização. Na emissão de créditos para essas remessas, a Sitron se reserva no direito de cobrar uma taxa para reposição de estoque dependendo da possibilidade de se recondicionar e revender os equipamentos devolvidos.

Informação confidencial: todos os desenhos, especificações e informações técnicas fornecidas pelo comprador ou pela Sitron, deverão ser tratadas como confidenciais, não serão divulgadas, exceto havendo necessidade de uma das partes, para fins de cumprimento de contrato. O comprador concorda que os desenhos e/ou matérias relacionadas são e permanecem como propriedades exclusivas da Sitron; o comprador não terá o direito a esta propriedade, quer seja em parte ou por completo.

Erros: a Sitron se reserva no direito de corrigir todas e qualquer tipografia ou erros escritos ou omissões em seus preços ou especificações.

Termos e Condições

Termos e condições Sitron

Design: a Sitron se reserva no direito de fazer qualquer alteração ou mudança necessária para melhorar seus produtos, corrigir defeitos ou tornar seus produtos mais seguros, sem aviso prévio ou consentimento do comprador.

Custos: todos os valores estipulados serão em Reais (R\$) e todas as cotações serão válidas por 30 (trinta) dias a partir da data da proposta, salvo quando especificado.

Instruções de Segurança: o comprador deverá garantir que seus representantes e profissionais envolvidos observem todas as instruções técnicas e de segurança contidos nos manuais de operação, catálogos ou outras instruções (escritas ou verbais) da Sitron.

Transporte e entrega: a partir do ato de liberação (expedição) da mercadoria, é de inteira responsabilidade do cliente o transporte do produto até o destino, arcando ele com os custos de frete e outros recursos de transporte e/ou seguro.

Atrasos no transporte: a Sitron não tem controle sobre o tempo que a mercadoria poderá ser mantida na alfândega. Por esta razão, a Sitron só se compromete a uma "data de expedição" e não a uma "data de entrega".

Entregas parciais: embora a Sitron se empenhe em fazer as entregas de seus pedidos em tempo hábil e por completo, a mesma se reserva no direito de entregar o pedido parcialmente, quando necessário.

Alterações: qualquer alteração feita pelo comprador e que afete as especificações do produto, tais como quantidade encomendada, data de entrega, método de transporte ou de embalagem, ponto de entrega, entre outros, deverá ser feito por escrito e assinado por ambas as partes.

Neste caso, a Sitron se reserva no direito para reajustar os preços e/ou entrega dos pedidos, que será acordado por ambas as partes antes de se prosseguir com os mesmos. Quaisquer desses pedidos serão cobrados de acordo com o escopo das mudanças e o andamento do pedido atual.

O cliente deverá assinar e devolver a aprovação dos desenhos juntamente com qualquer pedido. Se as aprovações não forem devolvidas juntamente com o pedido, a data de entrega poderá ser adiada até o reconhecimento dos mesmos.

Cancelamento: qualquer cancelamento de contrato por parte do comprador só será efetivo se for feito e aceito por escrito pela Sitron. Em tal caso, a Sitron reserva-se no direito de cobrar uma taxa de cancelamento razoável, incluído porém não limitado ao trabalho, material e outros gastos relacionados.



rev_08_2018

Sitron - Brasil
R. Baronesa de Itu, 83
São Paulo - SP - 01231-001
T: (5511) 3825-2111
F: (5511) 3825-2171

Sitron - USA
1800 Prime Place
Hauppauge, NY 11788
PH: 516-935-8001
FX: 800-516-1656

www.sitron.com

BRASIL: vendas@sitron.com

USA / Other Countries: info@sitron.com